



**CIRCULAR ACLARATORIA
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Circular N° 2	
Lugar y Fecha	Buenos Aires, 29/09/2017
Organismo contratante	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA

Organismo contratante	
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA	
GERENCIA DE ÁREA CAREM	
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	
Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES aprobado por R.P. 310/15	

Procedimiento de selección			
Tipo:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	N°	43/2017
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente	F-097-2017		
Rubro :	242 – EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO		

Objeto de la contratación:
ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL PARA CANAL ABIERTO

ACTO DE APERTURA:	
Lugar/Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3° Piso – Ala Correa – C.A.B.A. Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
Día y Hora	03/10/2017 A LAS 11:10 HS.
	De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 Hs. y de 14:00 a 16:00 Hs. hasta el horario de la apertura de las ofertas.

COSTO DE PLIEGO	SIN VALOR
VISITA A OBRA / INSTALACION	NO APLICA

DESCRIPCIÓN

CONSULTAS SOBRE EL ANEXO A – ESPECIFICACIONES TECNICAS –

Pregunta N° 1

En el Anexo A: Especificaciones Técnicas se solicita que los equipos incluyan los accesorios necesarios para la instalación.

Desconocemos donde serán instalados los equipos, y las dimensiones de la cámara de aforo para poder definir que accesorios son necesarios para el montaje del Sensor Ultrasónico que registrará las variaciones de altura en el canal abierto. ¿Por favor enviar un esquema dimensional para poder ver mejor donde serán instalados los equipos?

Respuesta N° 1.

El equipo será instalada en una cámara de aforo y toma muestra de hormigón, las medidas corresponden a la disposición del ADA 9/2014.

Se adjunta plano con dimensiones de la cámara.

M




Pregunta N° 2.

La fecha de apertura del presente concurso está prevista para 03/10/2017 a las 11:10 Hs en el predio CAREM Lima. Por favor informar si la apertura será pública para poder asistir.

Respuesta N° 2.

El procedimiento de selección para la Comparación de Cotizaciones N° 43/2017. La oferta puede ser enviada por mail al caremfc@cnea.gov.ar, hasta 2 horas antes del horario de apertura (11:10hs) ó entregar sobre en Lima provincia de Bs. As. Hasta las 11:10 hs. Si podrá asistir previa acreditación para ingresar. Recordamos Fecha de Apertura 03/10/2017 a las 11:10 Hs.

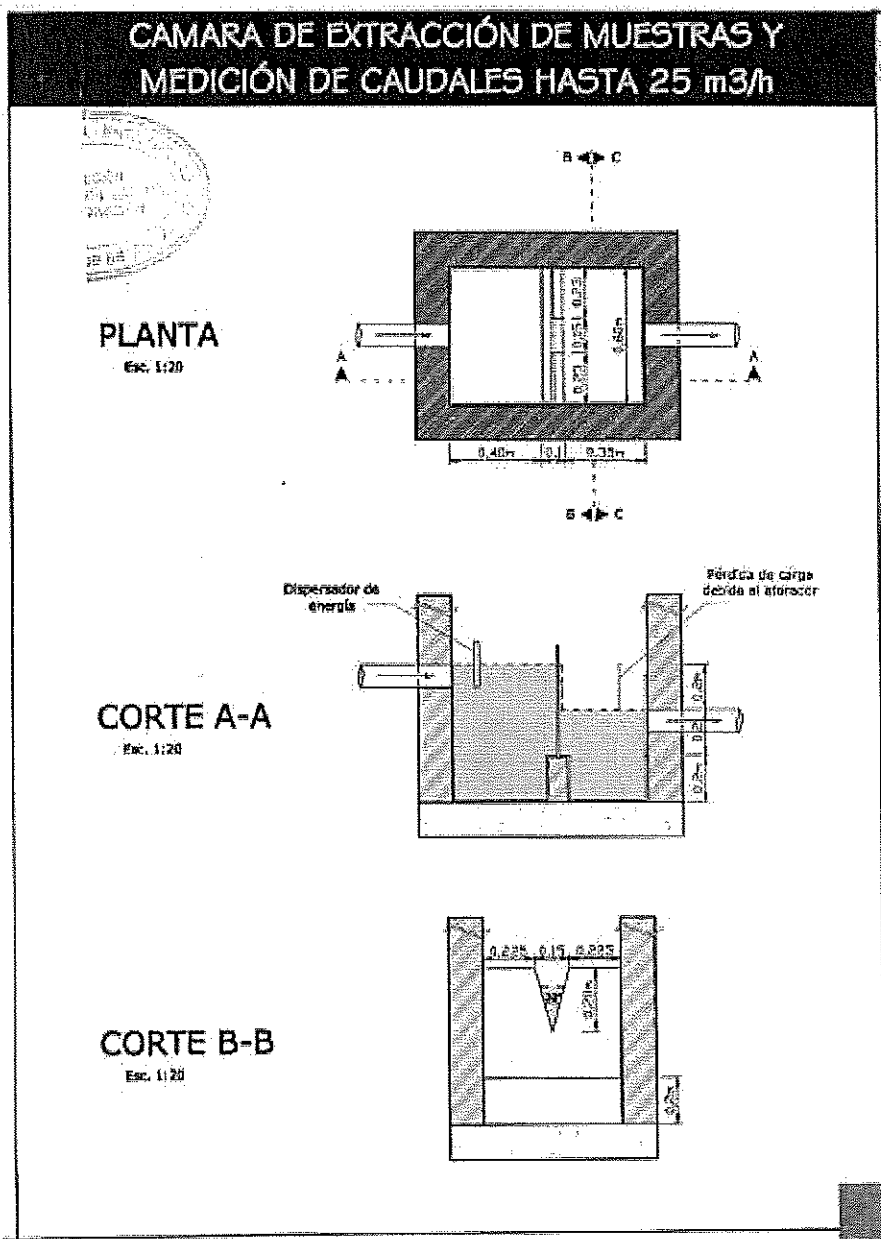

Liliana Garrigó
Firma y Aclaración
Ing. Liliana Garrigó
Jefe de División Medio
Amb., Seg. e Higiene
Gcía. de Area Carem